


A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. N-PKT

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ:		Auftragsnummer:	
<i>transmitter type:</i>		<i>job no.:</i>	
Serien-Nr.:		Referenzgerät:	
<i>serial no.:</i>		<i>reference unit:</i>	
Messbereich:		Prüfnorm, Temperatur:	
<i>temperature range:</i>		<i>testing device, temperature:</i>	
Ausgangssignal:		Serien-Nr.:	
<i>output:</i>		<i>serial no.:</i>	
Genauigkeit:		PTB-Zertifikat:	
<i>accuracy:</i>		<i>PTB certificate:</i>	
Kalibrierdatum:		Umgebungstemperatur:	
<i>date of calibration:</i>		<i>ambient temperature:</i>	

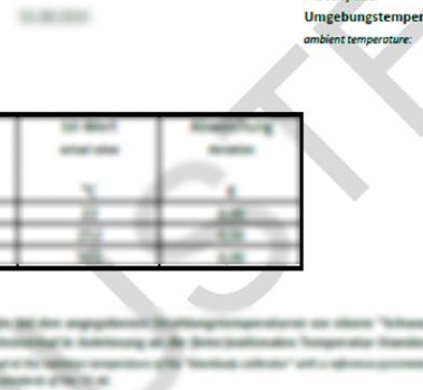

Ist-Wert <i>reference value</i>	Ziel-Wert <i>target value</i>	Abweichung <i>deviation</i>

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenz-Standard" nach einem Referenz-
Prozess der Vorgesellschaft in Anlehnung an die Internationalen Temperaturskizzen auf Basis der ITS-90.

The calibration was carried out in the "reference temperature" with "reference standard" in comparison reference method in
accordance with the standards of VDE 0113-10.

Die Angaben zur Messgenauigkeit beruhen auf den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen des
Kalibriergegenstandes gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Eindeutigkeitsgrad von 100 %.

The specifications regarding accuracy are based on the uncertainties of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
values refer to the certainty of 100 % of the measurement uncertainty.

Der gesamte große Messbereich, über dem gesamten Messbereich, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.

The entire great measuring range, over the entire measurement range, following a QM system certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is also calibrated and can be traced
back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
notice: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

für diesen gültig

Kalibrierung in 10000 Teilung

Temperatur

Abweichung: 0,01 / 0,02 / 0,05 °C

www.ifm.de

Tel.: +49 (0) 52 74 92 10 00

Peso	[g]	19,171
------	-----	--------

Observações	O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.
	O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.
	O certificado de calibração está em dois idiomas (alemão/inglês).
	Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.
	Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".
	4 pontos de medição no máximo, seleccionáveis de acordo com o requisito do cliente