

Certificado de calibración ISO para sensores de caudal

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: SM510

transmitter type: SM510

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...600 l/min

temperature range: 0...600 l/min

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,5 %

accuracy: ±0,5 %

Kalibrierdatum: 12.03.2018

date of calibration: 12.03.2018

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: SM510

reference unit: SM510

Prüfnormal, Temperatur: PTB-Zertifikat

testing device, temperature: PTB certificate


Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

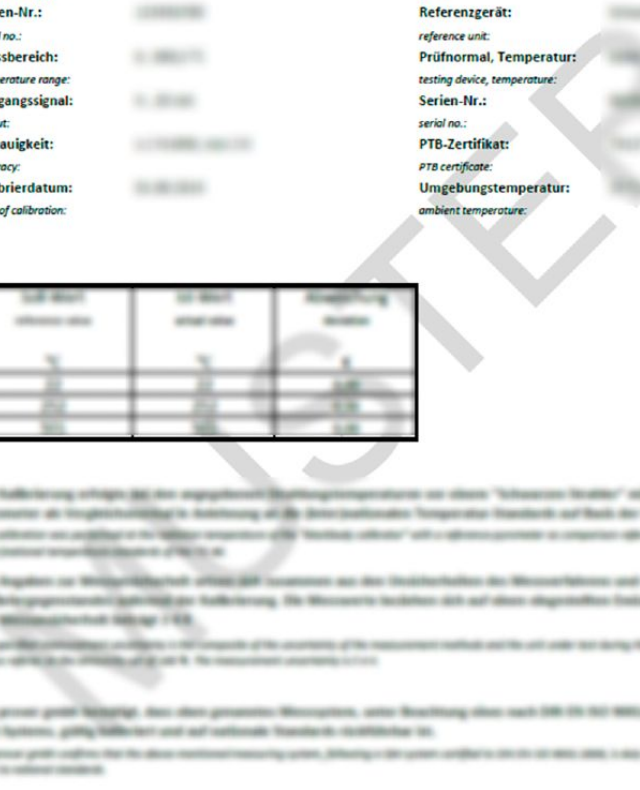

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzgerät" mit einem Referenz-Flussmesser der höchsten Genauigkeit in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormen und nach der PTB 98.

The calibration was carried out at the specified ambient temperature with a "reference device" with a reference flowmeter of the highest accuracy in accordance with the international temperature norms and according to PTB 98.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur gültig, wenn die Messumformer nach der Kalibrierung nicht verändert wurden und die Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgegrenzten Messbereich von 0 bis 100 %.

The specified measurement accuracy is only valid if the transmitter has not been changed after calibration and the calibration accuracy of the calibration. The measurement values are within a defined measurement range of 0 to 100 %.

The general guarantee applies to the measurement accuracy of the transmitter and the calibration accuracy of the calibration. The measurement values are within a defined measurement range of 0 to 100 %.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung einer Genauigkeit von 0,5 % bis 1,0 % sind in der Kalibrierung angegeben.

The exact measurement values, taking into account a measurement accuracy of 0,5 % to 1,0 %, are given in the calibration.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung einer Genauigkeit von 0,5 % bis 1,0 % sind in der Kalibrierung angegeben.

The exact measurement values, taking into account a measurement accuracy of 0,5 % to 1,0 %, are given in the calibration.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung einer Genauigkeit von 0,5 % bis 1,0 % sind in der Kalibrierung angegeben.

The exact measurement values, taking into account a measurement accuracy of 0,5 % to 1,0 %, are given in the calibration.

Campo de aplicación

Versión

En los SM0510 y SM2130 con un valor final de rango de medición de 900 l/min, la calibración y recalibración solo es posible hasta 600 l/min., para tipo, SM0510, SM2xxx, SM6xxx, SM7xxx, SM8xxx, SM9xxx

Datos mecánicos

Peso

[g]

33,17

**Certificado de calibración ISO para sensores de caudal**

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Notas

Notas

El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo.

El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración.

El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés).

Los pedidos a posteriori únicamente son posibles si el equipo se devuelve en un estado de limpieza aceptable.

En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".