

Certificat de calibrare ISO pentru senzorii de debit

ISO-Kalibrierung SD

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic 

Messumformer-Typ: 70000
transmitter type:

Serien-Nr.: 1000000
serial no.:

Messbereich: 0...100 l/min
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ±0.1%
accuracy:

Kalibrierdatum: 01.01.2017
date of calibration:

Auftragsnummer: 100000
job no.:


Referenzgerät: 100000
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: 100000
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 100000
serial no.:

PTB-Zertifikat: 100000
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 100000
ambient temperature:

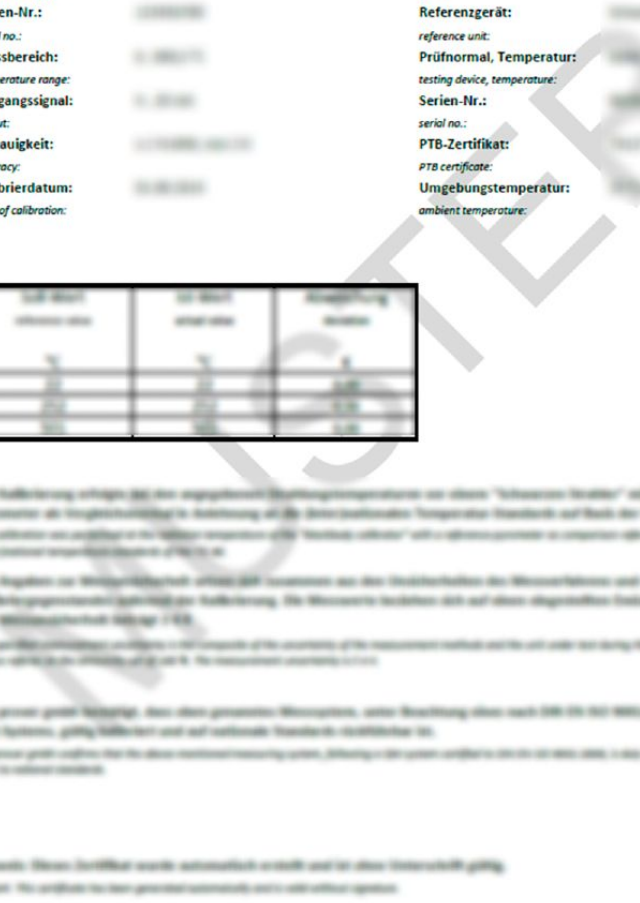

100 l/min	50 l/min	25 l/min
4.000	2.000	1.000
20.000	10.000	5.000
40.000	20.000	10.000
60.000	30.000	15.000
80.000	40.000	20.000
100.000	50.000	25.000

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur von einem "Referenz-Messgerät" mit einem Referenz-Sensoren als Vergleichsmittel in Abstimmung mit dem deutschen Temperatur-Standard auf Basis des PTB 90.
The calibration was performed in the testing temperature of the "reference sensor" with a reference sensor in comparison against a reference sensor in accordance with PTB 90.
Die Angaben zur Messgenauigkeit werden auf Basis der Unsicherheiten des Messverfahrens und denen der Kalibrierungsmittel gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgemessenen Füllungsgrad von 100 %.
The specified accuracy is based on the uncertainty of the measurement method and the uncertainty of the calibration. The measured value refers to a filling degree of 100 %.
Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur gültig, wenn die Messung unter Beachtung aller nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten ISO 9001 Systemen, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
The given accuracy is only valid if the measurement is carried out, following all the requirements of the DIN EN ISO 9001:2008, in a certified and traceable manner.
Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate was automatically generated and is valid without signature.
No power grade Testbed to 1000 l/min 1000 l/min
1000 l/min 1000 l/min 1000 l/min

Date mecanice

Greutate

[g]

5

Observații

Observații

certificatul de calibrare ISO nu este recunoscut conform EA MLA
(Multilateral Agreement) #i, prin urmare, este considerat ca netrasat.

Certificatul de calibrare trebuie comandat impreuna cu senzorul.

Senzorul corespondent este livrat impreuna cu certificatul de calibrare.

Certificatul de calibrare este in doua limbi (germana/engleza).

Comenzi ulterioare sunt posibile doar în cazul în
care senzorul este într-o stare curată la întoarcere.

In versiunea de internet a fisei tehnice este stocat un certificat in sectiunea "Descarcari"